Rekorder vorbereiten

1. Schließen Sie den SEER 1000 per USB-Kabel an den PC an.
2. Öffnen Sie die Praxissoftware und wählen Sie den gewünschten Patienten aus.
3. Rufen Sie HeartX Lift aus der Praxissoftware auf.
4. Klicken Sie auf ***EKG vorbereiten*** und übertragen Sie die Patienten-ID.

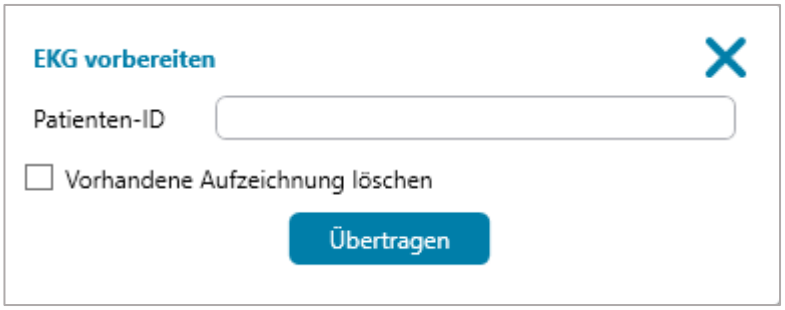

Der Rekorder ist nun zum Einsatz bereit.

EKG vorbereiten und starten

1. Bereiten Sie den Patienten vor – rasieren Sie ggf. die Haut und nutzen Sie feines Sandpapier zur Hautvorbereitung
2. Legen Sie dem Patienten die Elektroden an. Achten Sie dabei auf gute Elektrodenqualität.
   Wir empfehlen die EKG-Elektroden Ambu Blue Sensor L.
3. Nutzen Sie unser empfohlenes Anlageschema.

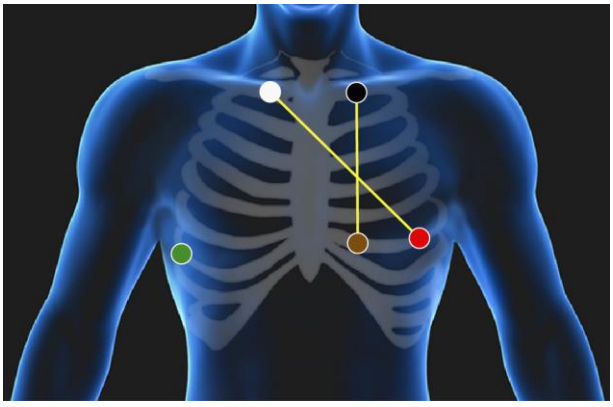

SEER 1000 Kabel 5-adrig (AHA)

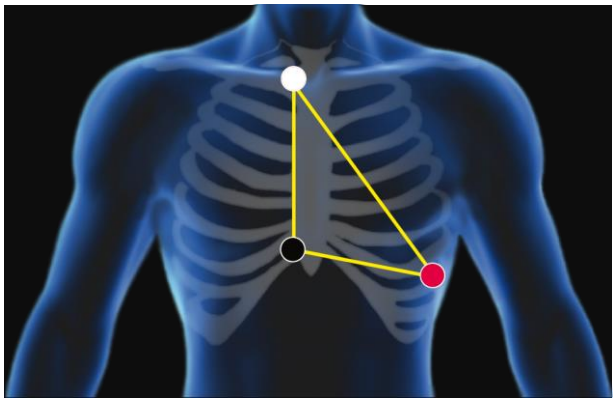

SEER 1000 Kabel 3-adrig (AHA)

4. Stellen Sie sicher, dass eine frische Batterie im Rekorder eingesetzt ist.
5. Verbinden Sie den SEER 1000 Rekorder mit dem Patientenkabel und drücken Sie die Ereignistaste bis ein Signalton ertönt, um den Rekorder einzuschalten.
6. Sobald beide LEDs am Gerät dauerhaft grün leuchten, starten Sie den Rekorder durch erneute Betätigung der Ereignistaste. Ein Signalton ertönt zur Bestätigung.
7. Prüfen Sie, dass die untere LED in regelmäßigen Abständen grün leuchtet. Dies bestätigt, dass die Aufzeichnung läuft.
   Der Rekorder schaltet sich automatisch, je nachdem welches Model verwendet wird, nach 24h, 48h oder 7 Tagen ab. Um die Aufzeichnung frühzeitig zu stoppen können Sie das Batteriefach öffnen.

EKG zur Auswertung senden

1. Verbinden Sie den SEER 1000 Rekorder per USB-Kabel mit Ihrem PC.
2. Öffnen Sie die ***HeartX Lift*** Applikation.
3. Klicken Sie auf ***EKG senden.***

Die EKG-Daten werden nun zu unserem HeartX Holter Auswerteservice übertragen.

EKG Report herunterladen

1. Sie werden durch eine E-Mail informiert, dass Ihr PDF-Report zur Durchsicht bereit ist.
2. Öffnen Sie die ***HeartX Lift*** Applikation.
3. Klicken Sie auf ***Bericht abrufen.***



Der Report kann nun aus der entsprechenden Patientenakte oder aus dem konfigurierten ***Report Directory*** Ordner geöffnet werden.

REF 79822011